



Ricerche svolte dal 1990

**SOCIETA' INTERNAZIONALE PER LE RICERCHE DI ELETTROSMOG
IGEF CERTIFICAZIONI
IGEF Laboratorio per le ricerche e per le sperimentazioni**

BREVI INFORMAZIONI SULLE ANALISI

**relative alla valutazione del "PXD Mobichip" della società PXD Sistema,
Macedonia concernente l'azione protettiva dalle radiazioni
elettromagnetiche durante l'uso di telefoni cellulari.**

Nel laboratorio IGEF per le ricerche e per le sperimentazioni è stata testata l'azione protettiva del "PXD Mobichip" della società PXD Sistema, Macedonia dalle radiazioni durante l'uso dei telefoni cellulari. Le presenti brevi informazioni contengono i risultati essenziali della ricerca. L'analisi del 02.06.2007 ha confermato che:

"PXD Mobichip"



della società' PXD Sistema
Leninova 79/1
1000 Skopje
Macedonia
Tel./fax: ++389 2 3229 473
internet: <http://www.pxds.com>
E Mail: marketing@pxds.com


è indicato per la protezione dell'organismo da radiazioni elettromagnetiche nocive dovute all'elettrosmog. E' altresì adeguato per uso negli altri apparecchi quali (telefono Vigila bebè, WLAN radio/tv reti). In base a quanto detto sopra sono adempite le esigenze dell'Associazione internazionale concernenti le ricerche relative all'elettrosmog IGEF ed è stato rilasciato il certificato contenente il timbro con dicitura approvato e raccomandato dall' IGEF.

Le prove sull'azione protettiva del "**PXD Mobichip**" sono state fatte per via del processo di effetto bioreversibile. 13 persone sono state sottoposte al test. Oltre alla diminuzione del potenziale stressante e l'influenza del "PXD Mobichip" sullo sviluppo dei processi ritmici nell'organismo, è stata anche testata l'adattabilità del corpo umano alle influenze esterne.


Risultati essenziali dello studio eseguito con il processo di effetto bioreversibile.


1. Diminuzione del potenziale stressante

Il valore medio del potenziale stressante è risultato ridotto del 13%, mentre presso singoli testati la riduzione ha raggiunto il 34%. La curva della conducibilità della pelle durante l'uso del "PXD Mobichip" si armonizza notevolmente.

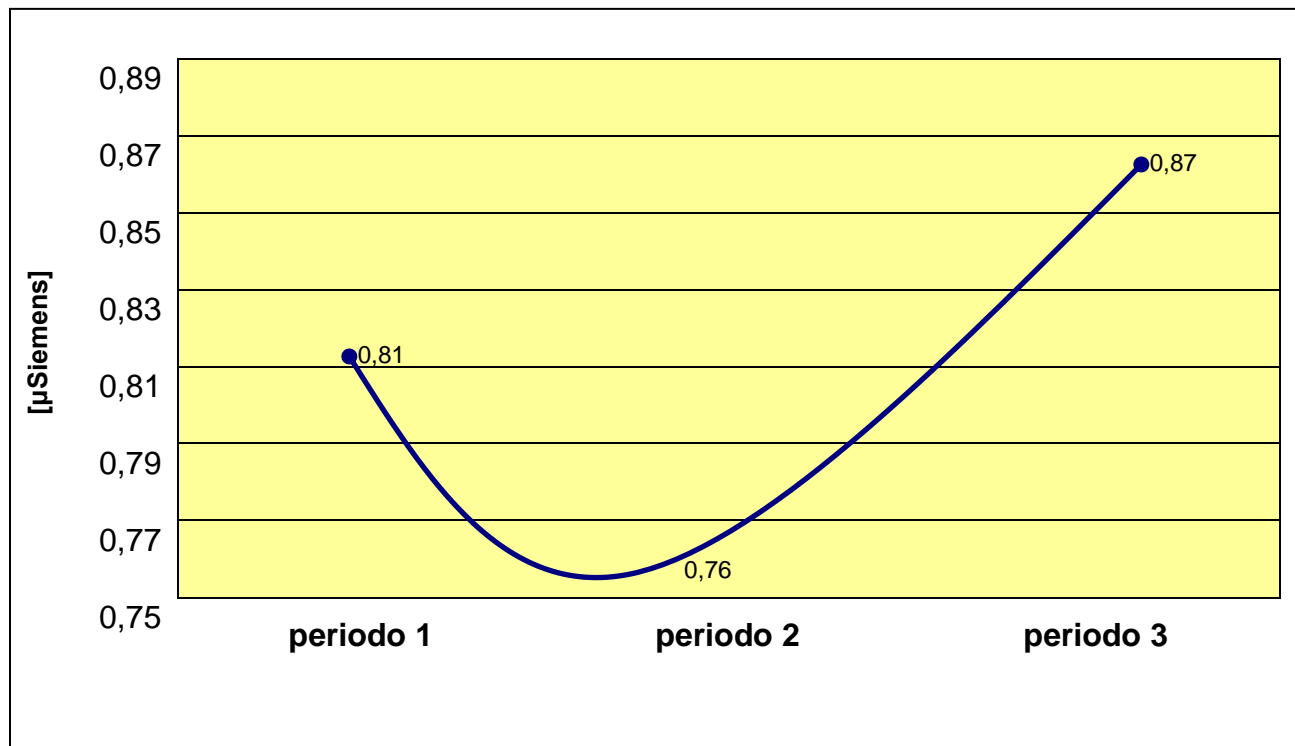

2. Miglioramento della variabilità dei battiti del cuore

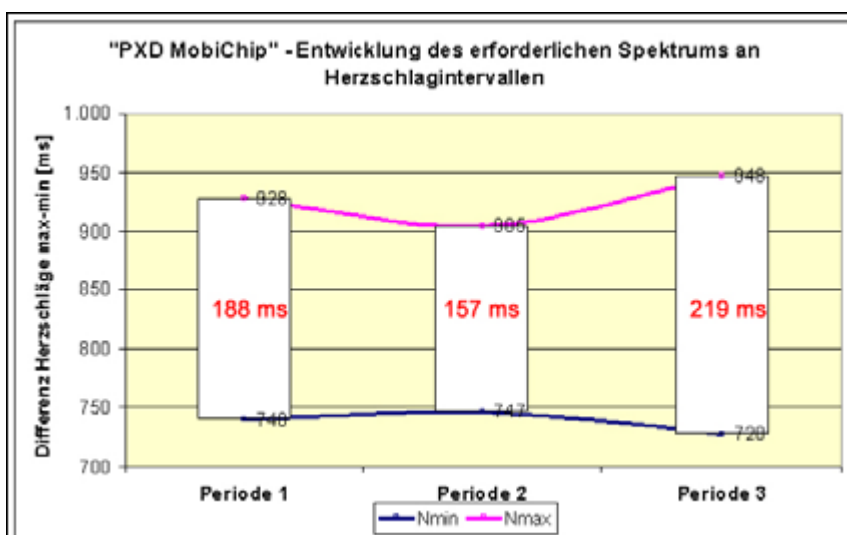

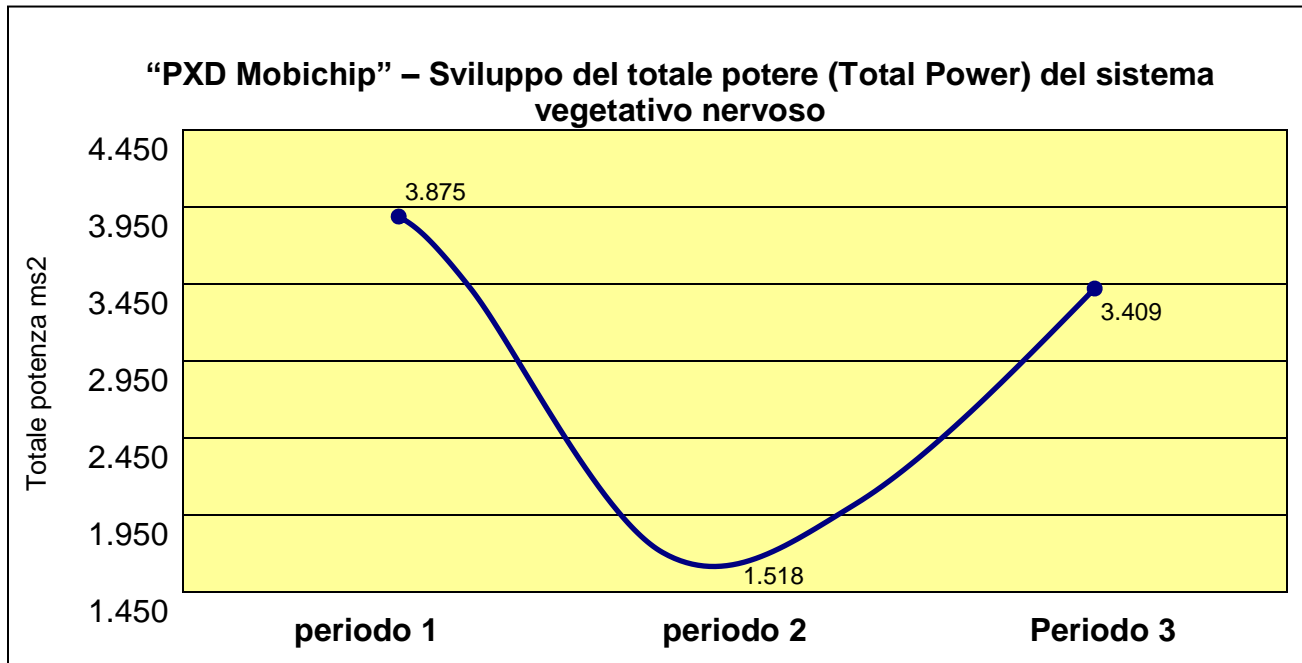

I risultati della ricerca hanno dimostrato che il campo informativo del „**PXD Mobichip**“ armonizza le influenze nocive dei campi elettromagnetici durante la loro influenza biologica sull’organismo e contribuisce al mantenimento dell’equilibrio interno dell’organismo umano. Il potere totale del sistema vegetativo nervoso diminuisce per oltre 50% con l’uso del „**PXD Mobichip**“. Si arriva altresì alla riduzione del numero di coppie consecutive di intervalli dei battiti del cuore con una differenza di > 50 ms, grazie al campo informativo del „**PXD Mobichip**“.

Ing. Paul Somer
Dirigente del laboratorio IGEF per le ricerche